PRODIMED
ONE SHOT

INSTRUMENTATION À USAGE UNIQUE

GAMME GYNÉCOLOGIE

SOMMAIRE

SETS EN BARQUETTES

Set de pose de stérilet 5
Set d'accouchement 6
Set d'épisiotomie 7

SATELLITES EN SACHETS INDIVIDUELS

Pince

Pince de Chéron 8
Pince Longuette / Colin 8
Pince de Pozzi 8
Pince de Bengolea courbe sans griffe 9
Pince de Kocher droite à griffes 9

Porte-aiguille

Porte-aiguille de Crile-Wood 10
Porte-aiguille Baumgartner 10
Porte-aiguille Halsey 11

Ciseaux

Ciseaux Metzenbaum courbe 11
Ciseaux Mayo droit 12
Ciseaux Mayo courbe 12
Ciseaux dauphin mousse mousse 13
Ciseaux dauphin pointu mousse 13

Curette

Curette à biopsie de Novak 13

ET SI NOUS PARLIONS **STÉRILISATION** ?

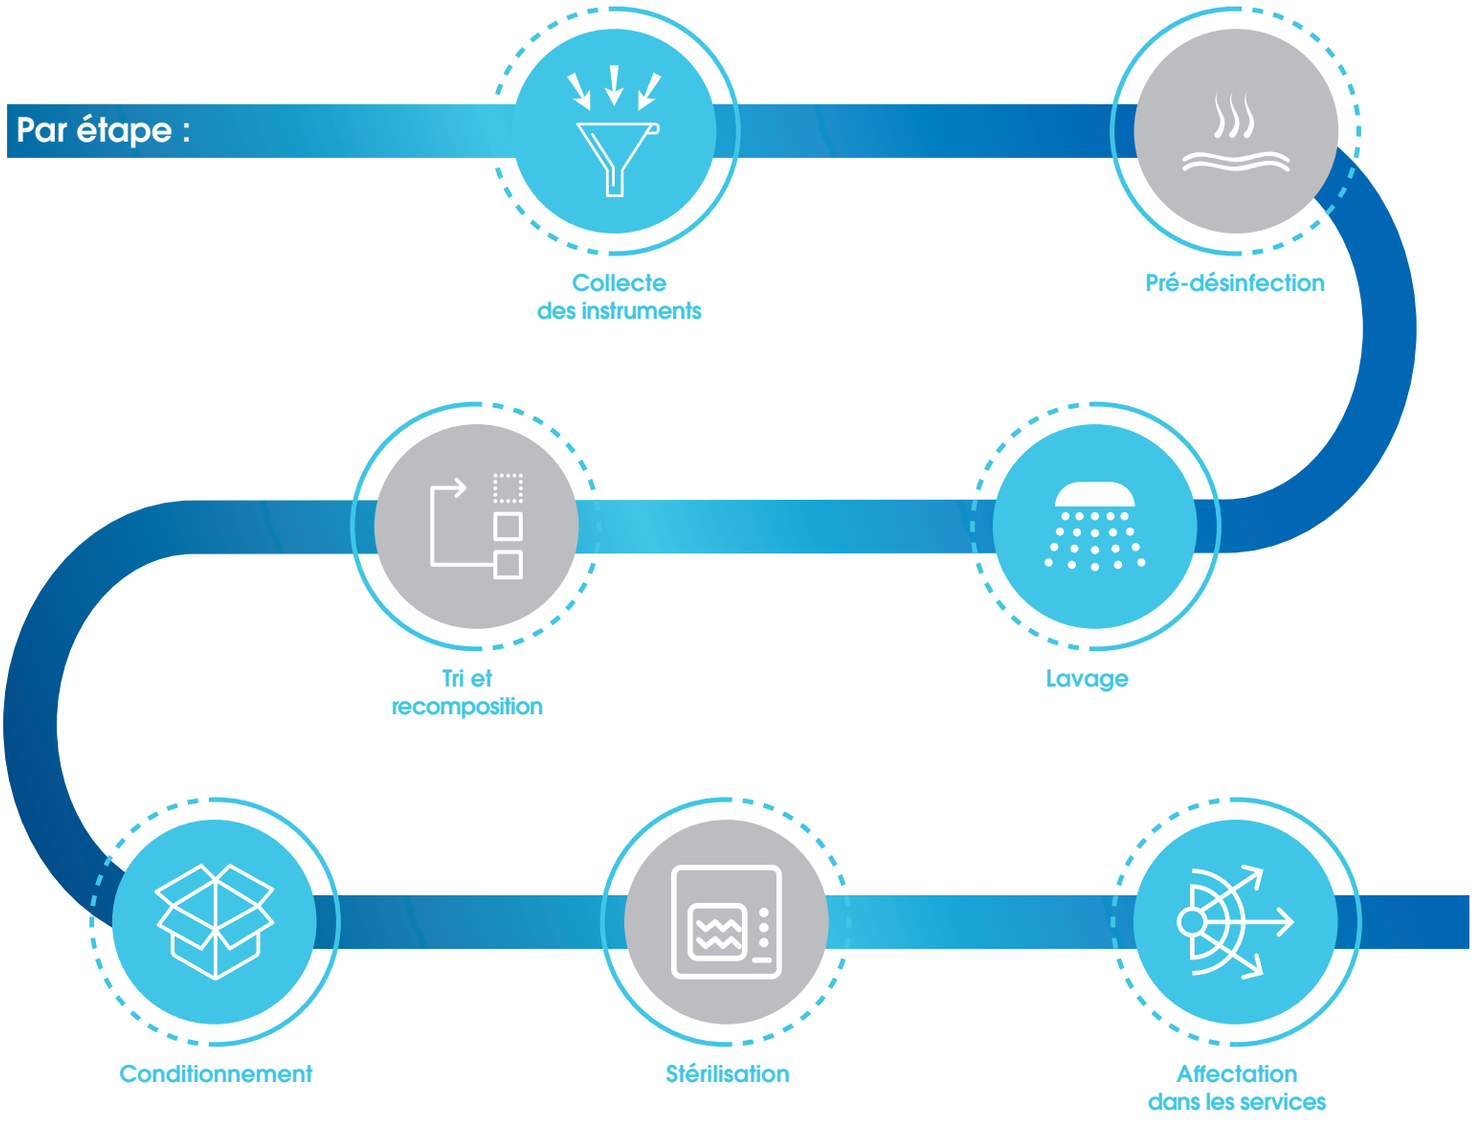

Gestion des DASRI :

2 options

Récupération / incinération :

Coût moyen observé =

750 € / TONNE

Pré-désinfection :

Coût =

GRATUIT

J'OPÈRE › JE RECYCLE

RECYCLAGE : revalorisation de l'inox récupéré, geste éco-responsable

LA **SOLUTION** POUR UNE PRATIQUE OPTIMALE

L'instrumentation à usage unique

- Des instruments prêts à chaque utilisation
- Des instruments stériles (péremption 5 ans)
- Une bande d'identification bleue

LES AVANTAGES

- **Gain de temps**
- **Optimisation des coûts**
- **Simplicité / Facilité**
- **Sécurité / Qualité**

La bande d'identification bleue en complément du symbole , permet un repérage clair et immédiat des instruments à usage unique.

Set de pose de stérilet

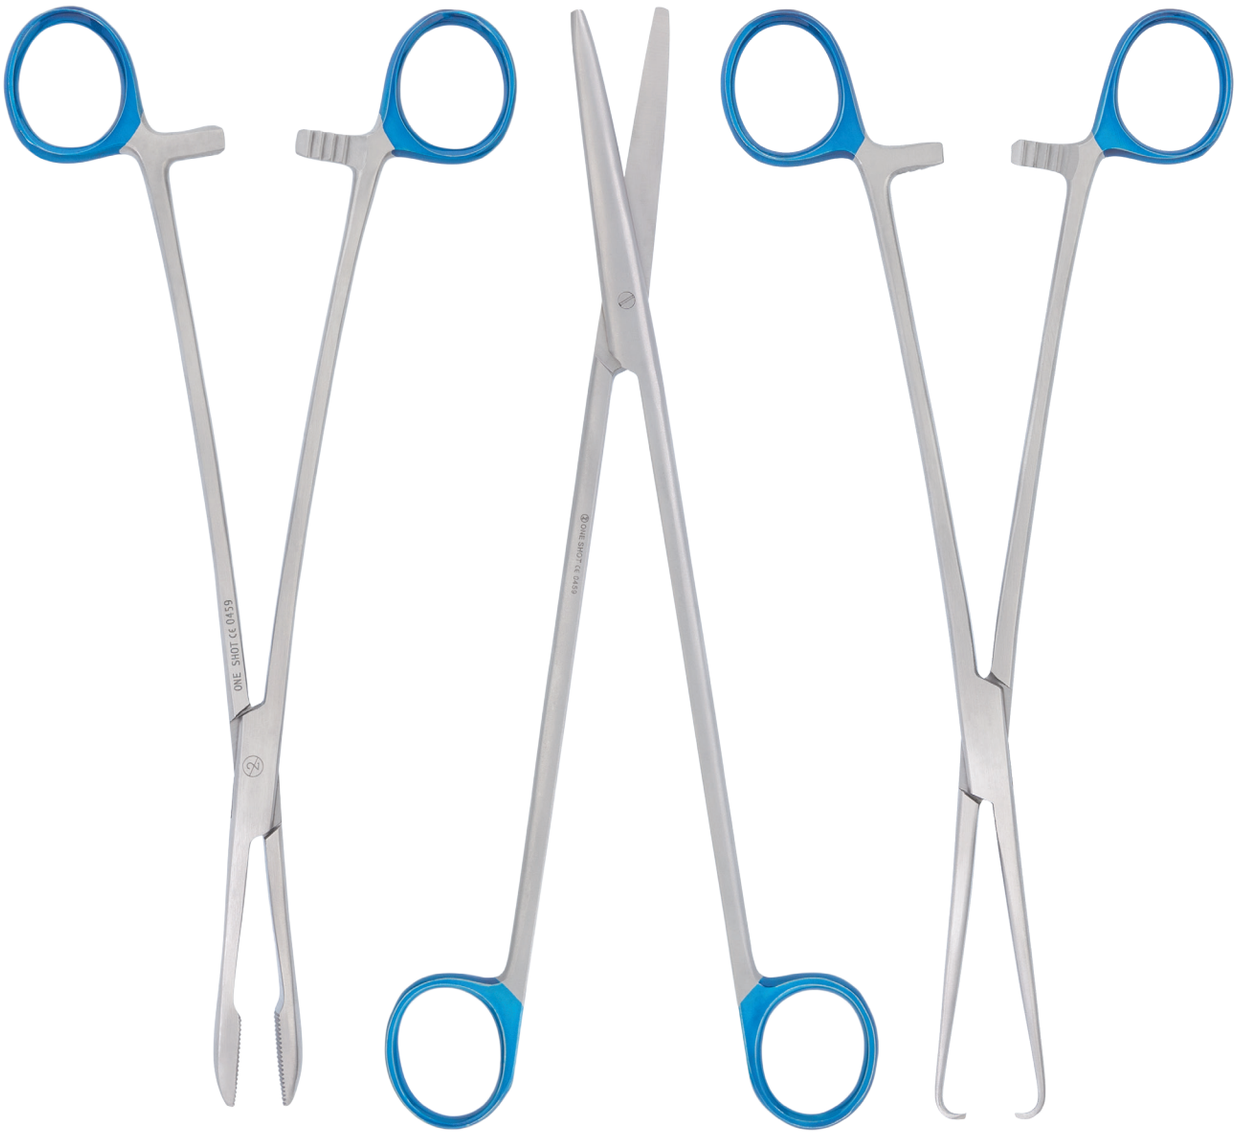

Composition

1 Pince de Longuette	25 cm
1 Pince de Pozzi	25 cm
1 Ciseaux de Metzenbaum courbés	25 cm
4 Boules tampons	
1 Cupule	

Référence interne	Référence de commande		Conditionnement	Emballage
7003534	OSSTERILET	15	Barquette	Double

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Set d'accouchement

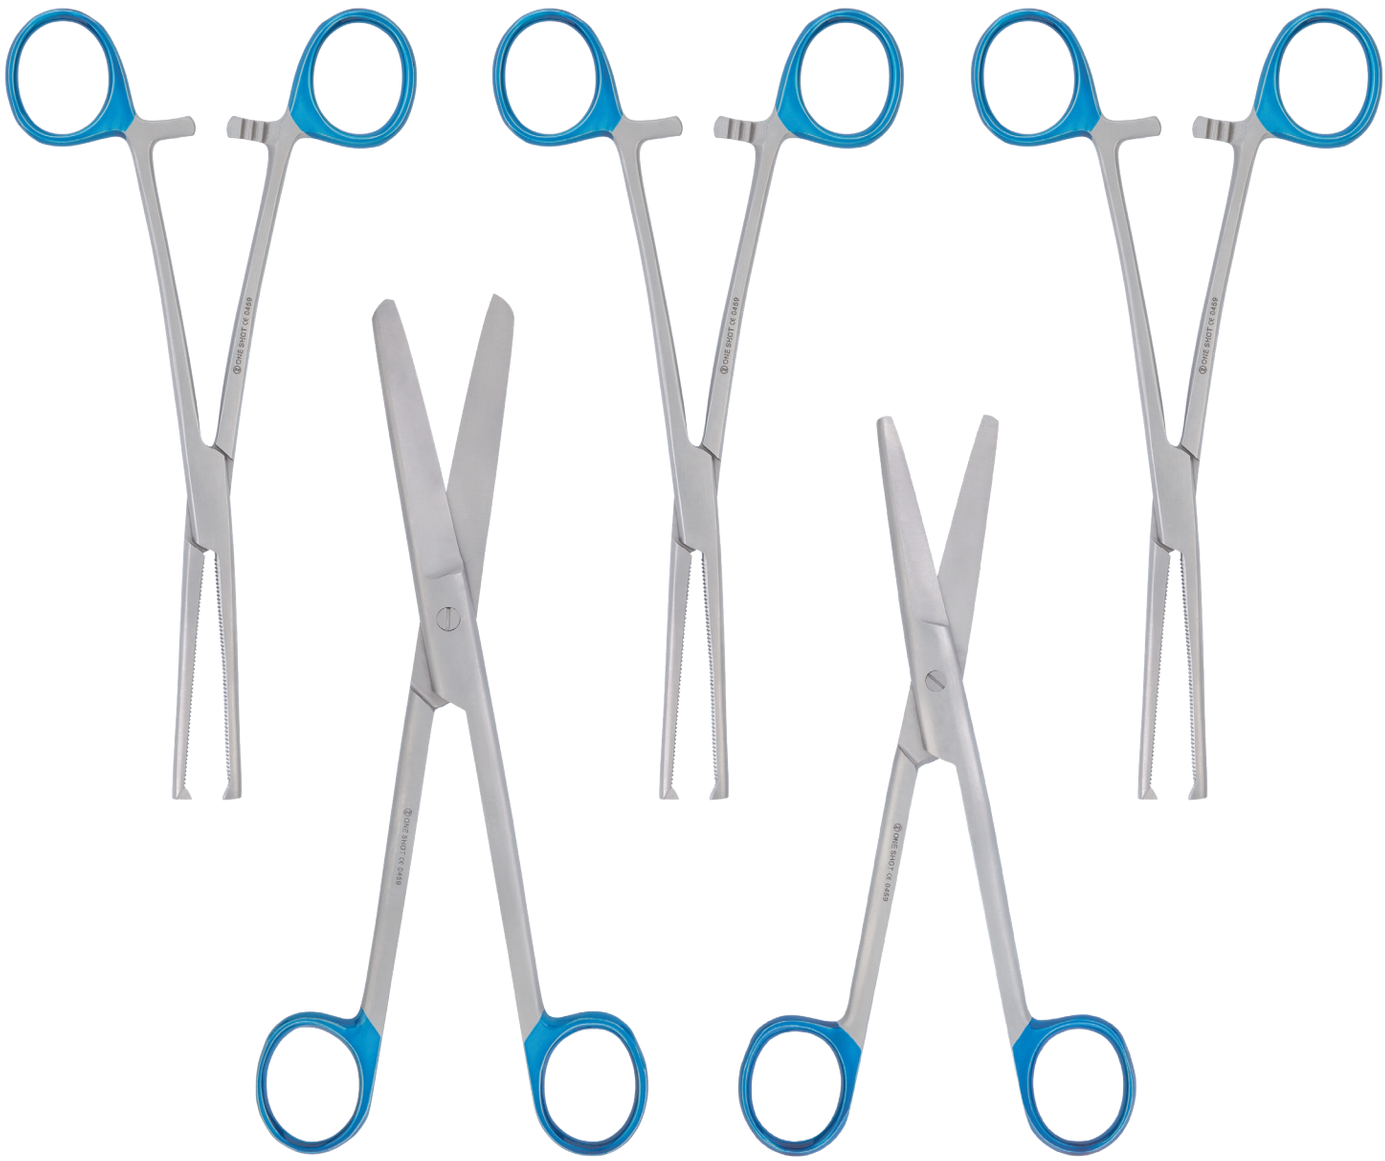

Composition

1 Ciseaux Dauphin mousse/mousse	20 cm
1 Ciseaux Mayo droits	17 cm
3 Pinces de Kocher à griffes	18 cm
10 Compresses (non tissées)	10 x 10 cm

Référence interne	Référence de commande		Conditionnement	Emballage
7004711	OSACCOUCH	15	Barquette	Simple

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Set d'épisiotomie

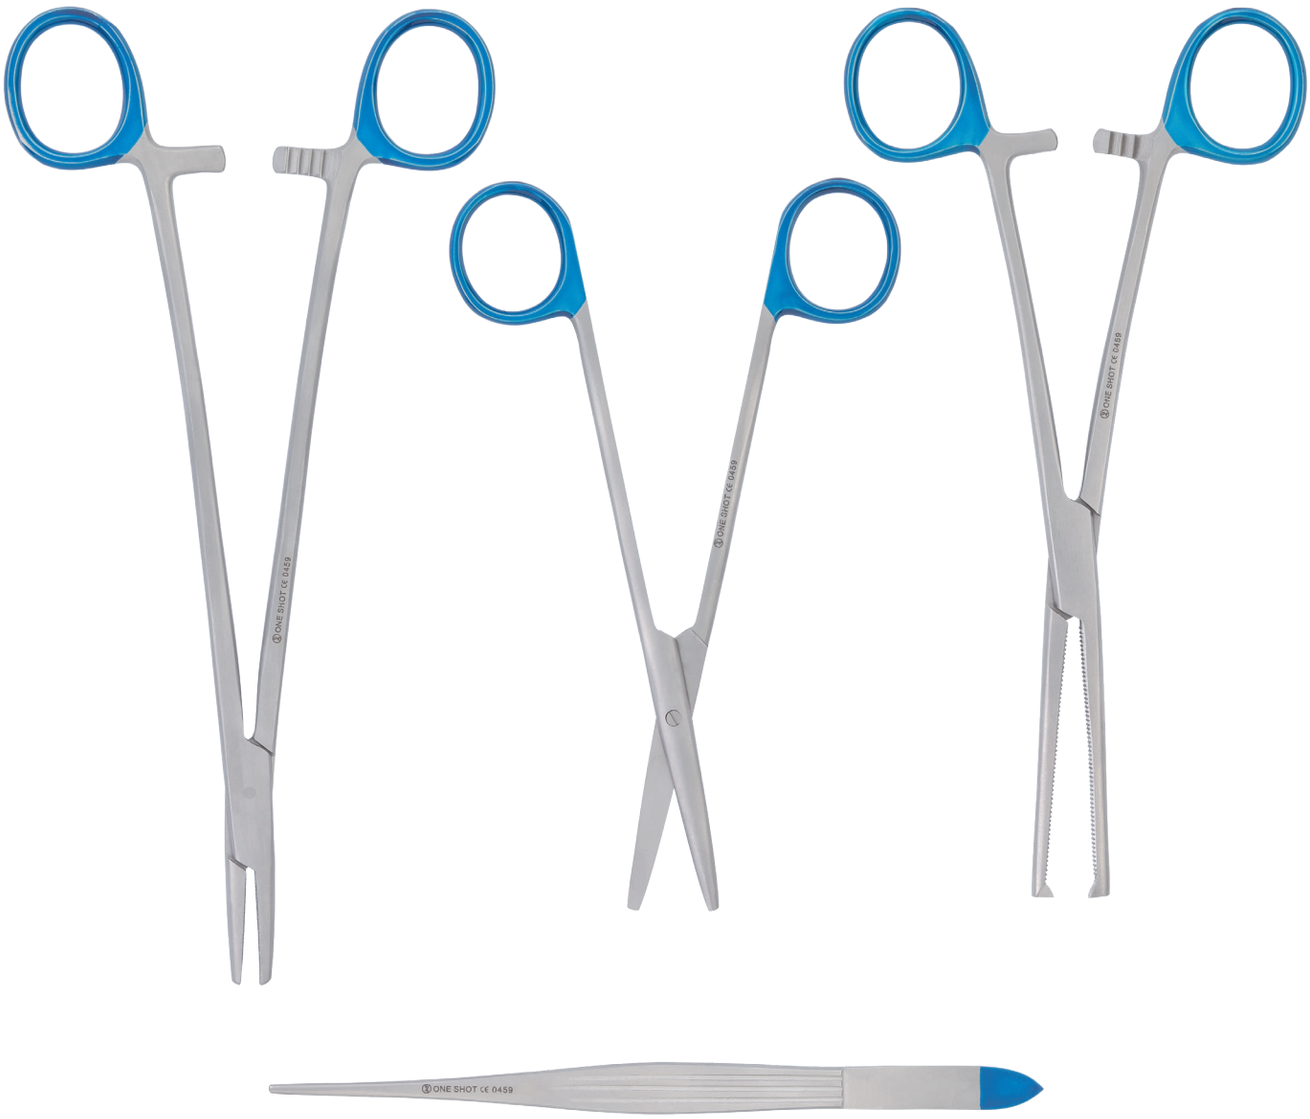

Composition

1 Porte aiguille de Crile-Wood	20 cm
1 Pince de Mac Indoe	15 cm
1 Pince de Kocher à griffes	18 cm
1 Ciseaux de Metzenbaum droits	15 cm
10 Compresses (non tissées)	10 x 10 cm
1 Cupule	

Référence interne	Référence de commande		Conditionnement	Emballage
7004709	OSEPISIO	15	Barquette	Simple

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Pince de Chéron

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003577	SAT225-05	25 cm	25	Boîte

Pince Longuette / Colin

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003576	SAT225-03	25 cm	25	Boîte

Pince de Pozzi

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003607	SAT881-04	25 cm	25	Boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Pince Bengolea courbe sans griffe

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003574	SAT167-02	20 cm	10	Boîte

Pince de Kocher droite à griffes

Référence interne	Référence de commande	Dénomination	⟷	📦	Conditionnement
7004551	SAT1245	Pinces de Kocher droite à griffes 16 cm	16 cm	25	Boîte
7004553	SAT1246	Pinces de Kocher droite à griffes 18 cm	18 cm	25	Boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Porte-aiguille de Crile-Wood

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003578	SAT243-04	20 cm	15	Boîte

Porte-aiguille Baumgartner

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003572	SAT1605	14 cm	15	Boîte

Porte-aiguille Halsey

Référence interne	Référence de commande	Dénomination	⟷	📦	Conditionnement
7003570	SAT1603-13	Porte-aiguille Halsey 13 cm	13 cm	15	Boîte
7003571	SAT1603-15	Porte-aiguille Halsey 15 cm	15 cm	15	Boîte

Ciseaux Metzenbaum courbe

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003545	SAT1027-25	25 cm	25	Boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Ciseaux Mayo droit

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003541	SAT1016-17	17 cm	15	Boîte

Ciseaux Mayo courbe

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003542	SAT1017	17 cm	15	Boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Ciseaux dauphin mousse mousse

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003540	SAT1002-20	20 cm	15	Boîte

Ciseaux dauphin pointu mousse

Référence interne	Référence de commande	⟷	📦	Conditionnement
7003539	SAT1001-15	15 cm	15	Boîte

Curette à biopsie de Novak

Référence interne	Référence de commande	↕	⟷	📦	Conditionnement
7003609	SAT907-32	2 mm	23 cm	10	Boîte
7003610	SAT907-33	3 mm	23 cm	10	Boîte

Dispositifs médicaux de classe IIa stériles. Fabricant : PRODIMED - CE 0459. Lire attentivement les instructions sur l'étiquetage.
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Ne pas utiliser si l'emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

BROCHURE ONE-SHOT GYNÉCOLOGIE - PS - 3000253 - V2 - 01/20 - création mg

PRODIMED
ONE SHOT

6, rue Louis Armand
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Service clients
Tél. : 01 44 95 17 00
Fax : 01 44 95 14 90
Email : serviceclients@ccdlab.com

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de l'impression. Toutefois, Prodimed se réserve le droit de modifier ou d'améliorer les dispositifs présentés. La société Prodimed est certifiée ISO 13485. ONE SHOT® est une marque déposée et propriété de la société Prodimed SAS.
Dispositifs médicaux stériles de classe Is et de classe IIa. Marquage CE 0459